



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM


Şartname Numarası : 44846
Düzenleme Tarihi : 08.02.2018

KOD : S-01030106 /

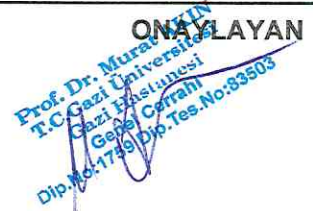
MALZEME ADI : MİKROÇATAL DİREKT SİNİR STİMÜLASYON PROBU (3/E-2)

1. Ürün Tek kullanımlı ve steril olmalıdır ve Kullanılacak tüp, cihaz aynı marka olmalıdır.
2. Ürün daha hassas ölçüm yapabilmesi için bipolar yapıda olmalıdır.
3. Ürün uc kısmına kadar yalısın ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürünün ucundaki ölçüm için bırakılan iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
5. Ürünün kablo uzunluğu en az 220 mm olmalıdır.
6. Ürünün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
7. Stimulasyon probunun bağlantı yerleri karışıklığı önlemek amacı ile farklı renkte olmalıdır.
8. Konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere?a uyumlu olmalıdır.
9. Malzenin orijinal barkod numarası olup, ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Malzeme CE sertifikasına sahip olmalıdır.
11. Ürünün şaft uzunluğu rahat kullanım açısından en fazla 10 cm ürünün toplam uzunluğu 15 cm yi geçmemelidir.
12. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kord lara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir
13. Ürün kullanım aşamasında firma tarafından ameliyathane teknik destek elemanı tarafından destek verilecektir

HAZIRLAYANLAR


Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781

ONAYLAYAN


Prof. Dr. Murat KAYIN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. No: 1759 - Dip. Tes. No: 83503