

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67019  
İstem Tarihi : 30.04.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 30.04.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CGASKL1  
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013703	GS1070 SKLEROTERAPİ İĞNESİ (ENDOSKOPİK)	10.00	ADET
Şartname Kodu	32292		

GASTROSKOP İÇİN

- 1-TEKLİF EDİLEN SKLEROTERAPİ İĞNESİ TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
- 2-TEKLİF EDİLEN SKLEROTERAPİ İĞNESİNİN İĞNE UZUNLUĞU 4MM VE 23 GAUGE OLMALIDIR.
- 3-TEKLİF EDİLEN SKLEROTEAPİ İĞNESİ KANAL ÇAPI 2.0MM VE DAHA ÜZERİNDE OLAN CİHAZLARLA KULLANIMA UYGUN YAPIDA OLMALIDIR.
- 4-TEKLİF EDİLEN SKLEROTEAPİ İĞNESİ BÖLÜMÜN İSTEĞİNE GÖRE 1.9MM VE 2.5MM OLARAK TESLİM EDİLMELİDİR.
- 5-TEKLİF EDİLEN SKLEROTERAPİ İĞNESİ CİHAZ AÇILANDIRILDIĞINDA KOLAY ENJEKSİYON YAPABİLMEK İÇİN KISA OLMALIDIR.
- 6-TEKLİF EDİLEN SKLEROTERAPİ İĞNESİNİN KATETER UZUNLUĞU KULLANICININ İSTEĞİNE GÖRE 180-230CM OLMALIDIR.
- 7-TEKLİF EDİLEN SKLEROTERAPİ İĞNESİNİN UÇ AÇISI 14 DERECE OLMALIDIR.
- 8-KATETER,STERİL VE ORJİNAL POŞETLERİNDE ,TESLİMAT TARİHİ İTİBARIYLA EN AZ 1 YIL MİADI OLMALIDIR.

  
Doç.Dr.Serhan SARI  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Hastanesi  
Çocuk Sağl.ve Hast.  
Dip.No:98.6601.91 Dip.Tes.No:59487/98137

  
Prof.Dr. Ahmet DİNGİÇ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Hastanesi  
Çocuk Sağl.ve Hast.  
Dip.No:98.6601.91

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67019  
İstem Tarihi : 30.04.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 30.04.2018  
Sayfa : 3

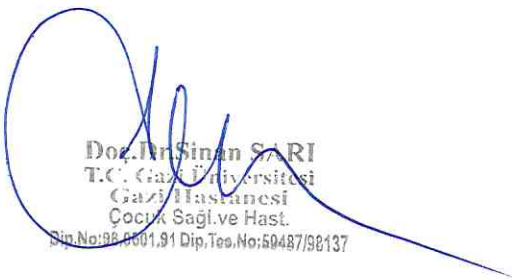
Bölüm Kodu : CGASKL1  
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010267	GS1930 KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ (İĞNELİ/İĞNESİZ) 2.8 MM. 240 CM.	20.00	ADET
Şartname Kodu	: 10520		

DISPOSABLE İĞNESİZ BİOPSİ FORSEPS (KOLONOSKOP)

- 1-Teklif edilen forseps tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Teklif edilen forseps oval kapakçıklara sahip olmalıdır.
- 3-Teklif edilen forseps 2.8mm çapındaki kolonoskop kanalından geçebilir özellikte olmalıdır.
- 4-Teklif edilen forseps uzunluğu 2300mm olmalıdır.
- 5-Teklif edilen forsepsin şaftı plastik kaplı olmalıdır.
- 6-Teklif edilen forsepsin tutamak kısmı plastik olmalıdır.
- 7-Teklif edilen forseps dar alanda biopsi almayı kolaylaştırıcı 90 derece dönebilen kapakçık yapısına sahip olmalıdır.
- 8-Teklif edilen forseps iğnesiz olmalıdır.
- 9- Teklif edilen forseps mevcut şartlarda kullandığımız olympus sistemle uyumlu olmalıdır.

  
Doç. Dr. Sinan SARI  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağl. ve Hast.  
Sin.No:88.0001.91 Dip.Tec.No:50487/98137

  
Prof. Dr. Bulent DALGIC  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağl. ve Hast.  
Doküman No: 10520