

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67489
İstem Tarihi : 30.05.2018 00:00:00
Açıklama : botox iğnesi

Döküm Tarihi : 30.05.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01E805	BOTOX İĞNESİ 37 MM.	100.00	ADET

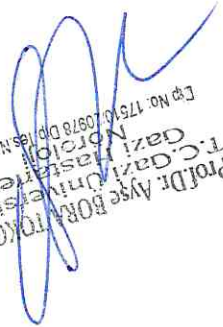
Şartname Kodu : 41097

BOTULİNUM TOKSİN TİP DISPOSABLE İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İğne özellikle Botulinum Toksin enjeksiyonu için üretilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
 - Botulinum Toksin iğnesi enjeksiyon esnasında elektriksel sinyalleri EMG cihazına iletebilir yapıda bir bağlantı aparatına (Kablo) sahip olmalıdır.
 - Her bir iğne ucu dokuya yumuşak giriş, optimum performans ve uygun konumlandırma sağlaması amacı ile uçtan arakaya boyuna ve çapraz kesim yöntemi ile şekillendirilmiş ve outstanding şekilde sivriltilmiş olmalıdır. Bu sayede uygulama yapılan üzerindeki doku hasarını minimuma indirmelidir.
 - İğne kanülü paslanmaz çelik den imal edilmiş olmalıdır.
 - Standart enjektörler ile kullanıma uygun olmalıdır. İğnenin enjektöre bağlanma bölgesinde Luer-Lock şeklinde bir kilit mekanizması olup bu mekanizma enjektör ün uygulama esnasında serbest kalmasını engelleyecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
 - Botulinum Toksin iğneleri tüm hasta gruplarına ve uygulama bölgelerine göre 6 değişik size da imal edilmiş olmalıdır.
 - İğneler steril tekli paketlerde ve 10 ar lık kutular içerisinde yer almalıdır.
 - Botulinum Toksin iğneleri, ölçülerinin kolay anlaşılması açısından enjektör kavrama bölgesi renklendirilmiş olmalı ve her renk ayrı bir uzunluğu temsil etmelidir.
- Genel iğne uzunluk ve ölçü tablosu aşağıdaki gibi olmalıdır;

RENK KODU	UZUNLUK	INCH	CALIBRE
Yeşil	38-38 mm	1,5??	0,45 26G


T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ İSTANBUL
UZM. DR. N. E. S. N. ERKÖKÜ ATAOĞLU
DIP. NO: 13987, DIP. T.C. NO: 117178


T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ İSTANBUL
UZM. DR. N. E. S. N. ERKÖKÜ ATAOĞLU
DIP. NO: 13987, DIP. T.C. NO: 117178

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 67489
İstem Tarihi : 30.05.2018 00:00:00
Açıklama : botox iğnesi

Döküm Tarihi : 30.05.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01E804	BOTOX İĞNESİ 25 MM.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 41096

BOTULİNUM TOKSİN TİP DISPOSABLE İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İğne özellikle Botulinum Toksin enjeksiyonu için üretilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
 - Botulinum Toksin iğnesi enjeksiyon esnasında elektriksel sinyalleri EMG cihazına iletebilir yapıda bir bağlantı aparatına (Kablo) sahip olmalıdır.
 - Her bir iğne ucu dokuya yumuşak giriş, optimum performans ve uygun konumlandırma sağlaması amacı ile uçtan arakaya boyuna ve çapraz kesim yöntemi ile şekillendirilmiş ve outstanding şekilde sivriltilmiş olmalıdır. Bu sayede uygulama yapılan üzerindeki doku hasarını minimuma indirmelidir.
 - İğne kanülü paslanmaz çelik den imal edilmiş olmalıdır.
 - Standart enjektörler ile kullanıma uygun olmalıdır. İğnenin enjektöre bağlanma bölgesinde Luer-Lock şeklinde bir kilit mekanizması olup bu mekanizma enjektör ün uygulama esnasında serbest kalmasını engelleyecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
 - Botulinum Toksin iğneleri tüm hasta gruplarına ve uygulama bölgelerine göre 6 değişik size da imal edilmiş olmalıdır.
 - İğneler steril tekli paketlerde ve 10 ar lık kutular içerisinde yer almalıdır.
 - Botulinum Toksin iğneleri, ölçülerinin kolay anlaşılması açısından enjektör kavrama bölgesi renklendirilmiş olmalı ve her renk ayrı bir uzunluğu temsil etmelidir.
- Genel iğne uzunluk ve ölçü tablosu aşağıdaki gibi olmalıdır;

RENK KODU UZUNLUK INCH CALIBRE

Açık Gri 25 mm 1?? 0,30 30G

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
UZM.DR. N. ERKOC ARAÇCI
NÖROLOJİ
DIP NO: 13852 DİP TES NO: 117176

Prof. Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip No: 17979/20978 Dip. Tes. No: 34601