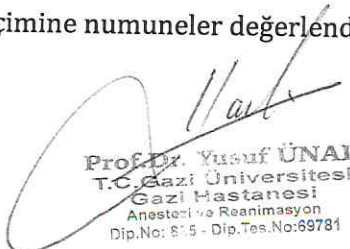


19

J01-011734

DISPOSABLE OYNAR BAŞLI DÜZ KAPATICI STAPLER 55-3.5 MM  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. İki sıra titanium zımba ile 55 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. 320 ° rotasyon, 120 ° artikülasyon yapabilmelidir
4. Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama işlemi yapılabilmelidir.
5. Kapama kolu 2 kademeli olarak kapanmalıdır . İlk seferinde Pin mekanizması otomatik olarak yerleşmeli , ikinci kademedede çene kısmı kapanmalıdır.
6. Derin bölgelerde kullanımı kolaylaştırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
7. Ayarlanan pozisyonun aynen doku üzerinde uygulanabilmesi için staplerin şaftı sert ve bükülemez olmalıdır.
8. Başlık ayarlandıktan sonra pozisyonu sabitleyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
9. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Bu mekanizmanın aktif olduğu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan siyah bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit edilebilmelidir.
11. Stapler ateşlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kitlenmelidir.
12. Staplerin kontrol dışı ateşlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
13. Staplerin renk kodlu kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3.5 mm, ateşlemeden sonra 1.5 mm olmalıdır.
14. Kartuşun içinde 19 ( ± 1 ) adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0.23 ( ± 0,01) mm olmalıdır.
15. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet sabit kartuş bulunmalıdır.
16. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
17. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
18. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
19. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
20. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

  
Prof. Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 815 - Dip.Tes.No:89781


  
T.C.  
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Prof. Dr. A. Bülent AYTAÇ  
Genel Cerrahi  
Dip.No:5387 Dip.Tes.30603


(2)

JO1-01734

DISPOSABLE OYNAR BAŞLI DÜZ KAPATICI STAPLER 55-4.8 MM  
TEKNİK ÖZELLİK

1. Disposable Olmalıdır.
2. İki sıra titanium stapler ile 55 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. 320 ° rotasyon, 120 ° artikülasyon yapabilmelidir
4. Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama işlemi yapılabilmelidir.
5. Kapama kolu 2 kademeli olarak kapanmalıdır . İlk seferinde Pin mekanizması otomatik olarak yerleşmeli , ikinci kademedede çene kısmı kapanmalıdır.
6. Derin bölgelerde kullanımı kolaylaştırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
7. Ayarlanan pozisyonun aynen doku üzerinde uygulanabilmesi için staplerin shaftı sert ve bükülemez olmalıdır.
8. Başlık ayarlandıktan sonra pozisyonu sabitleyecek kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
9. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
10. Bu mekanizmanın aktif olduğu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan siyah bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit edilebilmelidir.
11. Stapler ateşlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kitlenmelidir.
12. Staplerin kontrol dışı ateşlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
13. Staplerin renk kodlu kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
14. Kartuşun içinde 19 ( ± 1 ) adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0.28 ( ± 0,01) mm olmalıdır.
15. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet sabit kartuş bulunmalıdır.
16. Steril paketli malzeme en az 1 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
17. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
18. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
19. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
20. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

  
Prof. Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 825 - Dip. Tes.No: 69781

  
T.C.  
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Prof. Dr. A. Bülent AYTAÇ  
Genel Cerrahi  
Dip.No: 5387 Dip. Tes. 30603