
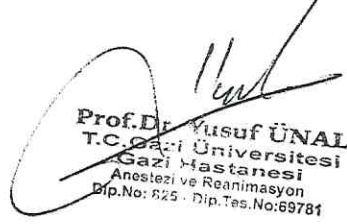


BİSTÜRİ UCU NO:20

1. Ürünler gamma ışınları kullanılarak sterilizasyon işlemi yapılmış olmalıdır.
2. Her bir kutuda 100 adet bistüri ucu bulunmalıdır.
3. Her bir bistüri ucu tek kullanımlık olmalıdır.
4. Steril tekli ambalajda no 2001 olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi minimum üç yıl olmalıdır.
6. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 625 - Dip.Tes.No:69781


Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 625 - Dip.Tes.No:69781

J01-014074 KAMERA KILIFI

1. Medikal amaçlı kullanıma uygun şeffaf malzemeden üretilmelidir.
2. 200 cm (+/- 30 cm) uzunluğunda ve 15 cm (+/-3 cm) genişliğinde olmalıdır.
3. Kolay açılımı sağlamak için başında karton başlık bulunmalıdır.
4. Steril açılımı bozmayacak şekilde iç içe geçerek katlanmış olmalıdır.
5. İki adet kilitli kablo bağı ve iki adet yapışkan çift taraflı şerit bant olmalıdır.
6. Ürün etilenoksit ile steril edilmiş olmalı, sterilizasyon indikatörü bulunmalıdır.
7. Örtü paketi üzerinde imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ürün içeriği yazılı olmalıdır.
8. Numune teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl miadı olmalıdır.
9. Her ürünün üzerinde birebir barkodu bulunmalıdır.
10. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de ;Ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.


Esra KAYA
Ameliyathane Sorumlusu

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
T.C. İstanbul Üniversitesi
Cerrahi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dış No: 825 - Dış Tes. No: 69781

CERRAHİ EL DİVEN (steril) NO:7,5

1. Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Eldivenin uzunluğu en az 280 mm, parmak ucu kalınlığı 0,18 mm (\pm 0.02mm), avuç içi kalınlığı ise 0,16 mm (\pm 0.02mm) olmalıdır.
3. Eldivenin doğal kauçuk lateks alerji (TIP I) riskini önlemesi amacıyla lateks protein içeriği 50 μ g/gr'dan küçük olmalıdır. Bu hususu karşıladığına dair akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Eldiven kullanıcılarında TIP IV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji riskini önlemesi amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasalları içermemelidir. Bu hususu karşıladığına dair akredite bir laboratuvardan alınmış test raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından kopma kuvveti yaşlandırma öncesi ve sonrası en az 13N olmalıdır.
6. Eldiven EN 455/1-2-3-4, standartlarına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. Bu standartları karşıladığına dair belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL seviyesi en fazla 1.5 olmalıdır.
8. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında sterilizasyon yöntem raporu sunulmalıdır.
9. Eldiven dış paketinde, ıslandığında ve kullanım da çabuk deformasyon oluşmaması ve sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
11. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
12. Eldivenlerin kutularında özel açma yeri olmalı ve eldiven boyları 7,5 olmalıdır.
13. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.


Soru Sorular
Ameliyathaneler
Sorumlu

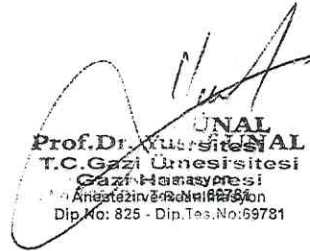
UNAL
Prof. Dr. Yunus İsmail UNAL
T.C. Gazi Üni. Sitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. Tes. No: 69781