



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Birim
1	100	ADET

143

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/2025-01-143  
Konu : DS merkez Ambar Stoku için 1 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoku  
Son Teslim Tarihi & Saat : 27/01/2025 17:00:00  
İlan Tarihi : 23/01/2025

Mehmet COBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Protorma fatüranın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-T1(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Uzerrinde kazınli, silindii, düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticareti unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
UBB kodu T.C. Sağlık ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem kalemler için ayrı ayrı TTUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTUBB/ÜTS ve kayıtlı firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.


\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.  
\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.  
\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEYECİKTİR.  
\*TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.  
\*ÖDEMELER MAL MÜLAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.  
\*E-POSTA :hasanesatfina@gazi.edu.tr

Opsiyon :  
Teslimat :  
EK :  
www.ihiss.gazi.edu.tr  
Şartname Eklisi Dosyasında Sunulmaktadır.

## SUBGLOTİK ALAN ASPİRASYONLU TRAKEOSTOMİ TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ NO:7,5

1. Tekli paketlenmiş ve steril olmalıdır.
2. Tüpün kendisi PVC'den üretilmiş olup şeffaf olmalıdır.
3. Kaf Poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
4. Kafın cidar kalınlığı en fazla 10 µm olmalıdır.
5. Latex içermemelidir.
6. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
7. Tüp iç çapı 7,5 mm olmalıdır.
8. Kaf özelliği yüksek hacim düşük basınç (HI-LO) olmalıdır.
9. Düşük kaf cidar kalınlığı sayesinde kafın şişirilmesi ile oluşabilecek kırışıklıkları önleyerek Ventilator kaynaklı Pnömoni' nin azalmasına yardımcı olmalıdır.
10. Tüp üzerinde aspirasyon hattı bulunmalı, hasta ventilatörden ayrılmadan trakeostomi tüpün özel sistemi ile subglotik alan aspirasyonu yapılabilir.
11. Distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tübün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır ve pilot balon konnektörü kesinlikle hava kaçağı yapmamalıdır.
12. Tüpün aspirasyon portunun, pilot balondan ayırt edilmesi için beyaz kapaklı olmalıdır.
13. Tüp trakeal bölgede takıldığı alanın görülebilmesi sağlanması amacı ile şeffaf kanatlara sahip olması gerekmektedir.
14. Distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tübün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır.
15. Tüpün tespit kanalları üzerinde boyu ve ölçüsü yazılı olmalıdır.
16. Tüpün üzerinde X ray' de görülmesini sağlayan çizgi bulunmalıdır.
17. Tüpün ucunda 15 mm konnektör olmalıdır.
18. Tüpün içerisinde geçen obtüratör tıkanıklığı açabilecek nitelikte olup, tüpün ucundan görülebilir nitelikte olmalıdır.
19. Tüpün paketinin içerisinde trakeostomi kanülü, obtüratör ve tespit (sabitleme) bağı olmalı ve bu bağ beyaz renkli olmalıdır.
20. Tüpün kutusunda Türkçe kullanım talimatı olmalıdır.
21. Subglotik alan aspirasyonlu trakeostomi tüpünün paketinin üzerinde iç ve dış çaplarının yazılı olması gerekmektedir.
22. Ürünün CE belgesi ve TITUB kaydı olmalıdır.
23. Örnek numuneler ambalajında gelmelidir ve değerlendirme aşamasında muhakkak gönderilmelidir. Hastanemiz kliniklerinde kullanıcılar tarafından denenerek karar verilecektir.

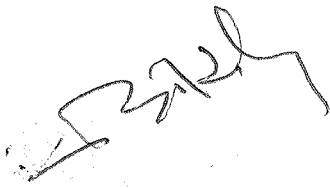

Nuray DELEN  
İç Hast. Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşire

