



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alınım No : 239/2025-02-390
Konu : Ameliyathane Stoju (Robotik Cerrahi) için 8 kalem malzeme alınımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stoju
Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2025 17:00:00 İlan Tarihi : 20/02/2025

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins , miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Performa faturamız aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alınma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazını silinti, düzeltilme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya kıcalet unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyeceğe FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine, müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin ÜBB kodu teklifte yer alacaktır.
ÜBB Kodu, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTÜBB) veya/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTÜBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTÜBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, teklifçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NÜMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELEER MAL MUAYENE KABULÜNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hasnanesalim@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Miktar	Malzeme Adı/Anlamı	Miktar	Birim
1	J01-01E414	ENSTRUMAN KOLU ORTUSU (ROBOTİK CERRAHI)	100	ADET
2	J01-01F073	TIP COVER (ROBOTİK CERRAHI)	20	ADET
3	J01-01E465	CANNULA SEAL 8 MM (ROBOTİK CERRAHI)	20	ADET
4	J01-01F088	ROBOTİK BİPOLAR MARYLAND FORCEPS (ROBOTİK CERRAHI)	3	ADET
5	J01-01F084	MONOPOLAR CURVED MAKKAS (ROBOTİK CERRAHI)	5	ADET
6	J01-01F060	FENESTRATED BİPOLAR FORCEPS (ROBOTİK CERRAHI)	5	ADET
7	J01-01F067	PROGRASP FORCEPS (ROBOTİK CERRAHI)	3	ADET
8	J01-01F591	LARGE NEEDLE DRIVER (ROBOTİK CERRAHI)	3	ADET

Mehmet ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
EK :
www.hiss.gazi.edu.tr
Şartname Eklil Dosyasında Sunulmaktadır.

J01-01E414 ENSTRÜMAN ARM DRAPE

- 1-Ürün Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD robotik cerrahi sisteminin enstrüman kollarını örtmek ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında kolların kullanımını sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
 - 2-Malzeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanıma hazır olmalıdır.
 - 3-Örtüler şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.
 - 4-Üzerlerine monte edilmiş plastik aparatlar sayesinde örtüler kollara tutturulabilmelidir.
 - 5-Plastik aparatlar ameliyat esnasında kullanılan enstrümanlar ile robotik kolları birbirine bağlayan ve robotik kolların hareketlerini sınırlamayacak tarzda dizayn edilmiş olmalıdır.
 - 6-Örtünün üzerinde örtüyü kola sarmayı sağlayan özel bantlar olmalıdır.
- Örtü Kolu kısmen değil tamamen örtecek şekilde olmalıdır



Edri GÜNEŞ KARAVELİ
Ameliyat Birim Sorumlusu

J01-01F073 TIP COVER

- 1-Malzeme Hastanemizde bulunan da Vinci S , da Vinci Si HD ve da Vinci Xi sistemi ile kullanılacak olan Monopolar makasa uyumlu olmalıdır.
- 2-Tip Cover? in makas ucuna takılmasını kolaylaştırmak için etrafında bir koruyucu kılıf bulunmalıdır.
- 3-Koruyucu kılıf Tip Cover makasa takıldıktan sonra yana doğru açılarak makas ucundan ayrılabilmelidir.
- 4-Monopolar makasın bilek kısmından dokuya elektrik akımını engellemek üzere izolasyon yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 5-Makasın hareketlerini engellemeyecek esneklikte olmalıdır.



Edra GÜNEŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Başkanı

J01-01E465 Instrument Cannula 8 mm 420002


1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci Sİ HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kanül ölçüleri en az 12.7x12.7x 30.48 cm olmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Remote Center'ı gösteren siyah şerit olmalıdır.
4. Trokar robota takıldığında robot tarafından otomatik tanınabilme özelliği olmalıdır.

Doc. Dr. R. ...
...
...

Ebru GÜMÜŞKIR, Yrd. Doç. Dr.
Ameliyathane Birim Sorumlusu

J01-01F068 MARYLAND BİPOLAR FORCEPS TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin kuvveti orta düzeyde olmalıdır.
4. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.
5. Çenelerin her birinin uzunluğu 1,9cm ile 2,1cm arasında olmalıdır.
6. Enstrümanın toplam uzunluğu 54cm ile 57cm arasında olmalıdır.
7. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.

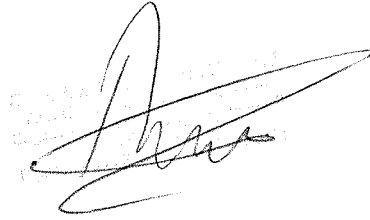

Ebru GÜZEL KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F064 MONOPOLAR CURVED MAKAS (ROBOTİK CERRAHİ)


- 1.Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.
- 4.Çenelerin her birinin uzunluğu 1,2cm ile 1,4cm arasında olmalıdır.
- 5.Enstrümanın toplam uzunluğu 55cm ile 57cm arasında olmalıdır.
- 6.Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilirmeli

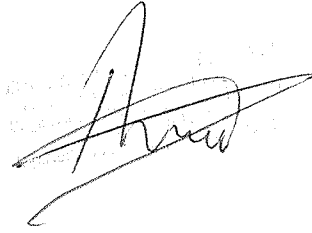

EDİT GÜRSER KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F060 FENESTRAD BİPOLAR FORCEPS (Ş.NO.42752)


- 1.Enstrüman Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Enstrüman cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Çenelerin kuvveti orta-orta düzeyde olmalıdır.
- 4.Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.
- 5.Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,2cm arasında olmalıdır.
- 6.Enstrümanın toplam uzunluğu 55cm ile 57cm arasında olmalıdır.
- 7.Enstrüman 8mm çapında olmalıdır.
- 8.Enstrüman 10 ameliyatta kullanılabilir.

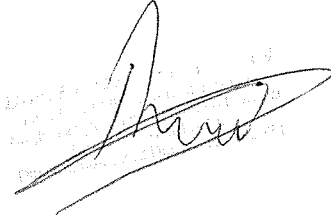


Edru GÖMÜŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu

J01-01F067 PROGRASP FORCEPS

- 1.Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Malzeme cerrahın el bileđi hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Çenelerin kuvveti yüksek - düşük düzeyde olmalıdır.
- 4.Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.
- 5.Çenelerin her birinin uzunluđu 2,7cm ile 3,1cm arasında olmalıdır.
- 6.Enstrümanın toplam uzunluđu 54cm ile 58cm arasında olmalıdır.
- 7.Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilirdir.

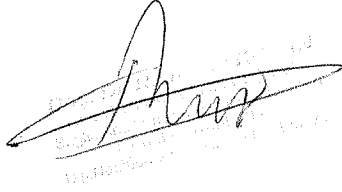



ZORU GÖNÜS KÖRVELİ
Ameliyat Birim
Sürgeon

JUL 01/15 91

J01-011078 LARGE NEEDLE DRIVER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Malzeme cerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Çenelerin açılma açısı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.
4. Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9 cm ile 1,2cm arasında olmalıdır.
5. Enstrümanın toplam uzunluğu 54 cm ile 56 cm arasında olmalıdır.
6. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilir.

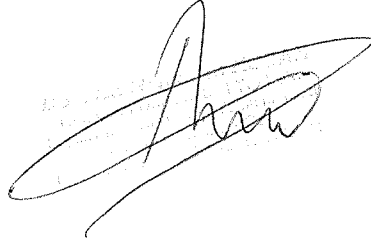

Ebru GÜNEŞ KARAVELİ
Ameliyathane Birim
Sorumlusu