



T.C  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İslem No/Alım No : 2163924-06-2425  
Konu : 1 Kalem buhar kimyasal indikatör alımı  
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu  
İlan Tarihi : 24/06/2024  
Son Teslim Tarih & Saati : 29/06/2024 17:00:00

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalajı şekillerinin yazılması
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilmeli, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Teklif verilen malzemenin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.  
ÜBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası İnternet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

\*\*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

\*\*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

\*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

\*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEKTİR.

\*TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA: hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mikodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-015017	BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR	50000	ADET

MEMİŞ ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD.

Opsiyon :

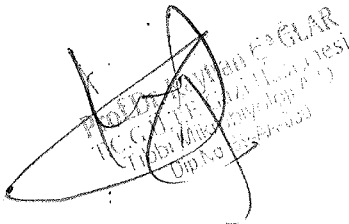
Teslimat :

EK :

www.jhsis.gazi.edu.tr  
Sarıname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

015017 - BUHAR OTOKLAVI KİMYASAL İNDİKATÖRÜ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm 134 derece ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilirdir.
2. Mürekkep transferini önleyen materyal ile kaplı olmalıdır.
3. İndikatörde kullanılan materyaller sterilizasyon süresince çekme buruşma yapışma vb. olmamalıdır.
4. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir, kayıt olarak saklanabilmelidir.
5. Buhar kimyasal indikatörü üzerinde 134°C - 7 dakika olduğu belirtilmelidir.
6. Sterilizasyon işleminin uygun olmaması durumunda (buhar, ısı ve süreden herhangi biri) strip üzerindeki imge referans renge dönmemelidir. Uygun sterilizasyon sonrasında renk deęişimi parametre üzerinde net olarak fark edilmeli, yorumuna dayanmamalıdır.
7. Kimyasal indikatörün işlem sonrası neyi ifade ettiğini ve sorun varsa kaynağını anlatan, kolayca okunabilen renk deęişim tablosunu teklif dosyası ile birlikte verilmelidir.
8. En az 25 adet numune verilmelidir.
9. Ürün lot numarası ve son kullanma tarihi her indikatörün üzerinde ve paket üzerinde yer almalıdır.
10. Ürün son kullanma tarihi, ürün teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
11. Normal oda koşullarında (15-30 derece ve %35-60 nem) saklanabilmelidir.
12. Bu ürün EN ISO 11140 standardında sınıf 4-5 veya 6 ürün sınıflandırma sertifikası olmalıdır. Teklif dosyasına eklenmelidir.
13. Ürünün uygunluęuna Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından karar verilecektir.

  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.  
Dip No: 7194

  
Prof. Dr. Ayşe KALKANCI  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.  
Dip No: 7194