



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İsten No/Alım No : 218/2024-07-2596  
Konu : 5 kalem malzeme alımı  
Talep Eden Birim : Poliklinik Depoları / Pediyatrik Allerji Polikliniği Stogu  
Son Teslim Tarih & Saat : 08/07/2024 17:00:00  
İlan Tarihi : 04/07/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Profoma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alıma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeveyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
Önemli 10- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
Önemli 11- İhale ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) için ayrı ayrı TTTUBB' de/ UTS'de Sağlık Kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. Bakanlık tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.  
Önemli 11- İhale ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (UTS)'ye kayıtlı ve bu UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TTTUBB) için ayrı ayrı TTTUBB' de/ UTS'de Sağlık Kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TTTUBB' de/ UTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. Bakanlık tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve teklifçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TTTUBB/UTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- \*\*ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
- \*\*İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
- Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
- \*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
- \*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
- TEKLİFLER BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
- ÖDEMELER MAL NUAİYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
- E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J07-075601	CLAVULANIC DUYARLILIK TEST KİTİ	3	ADET
2	J07-075600	AMOXICILIN DUYARLILIK TEST KİTİ	3	ADET
3	J08-011764	LANSET (PRICK LANSET)	10000	ADET
4	J06-069241	APS BRONŞ PROVAKASYON FİLTRESİ	500	ADET
5	J01-01E772	OR2740 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ İÇİN BAKTERİ FİLTRESİ	5000	ADET


Memiş ÇOBAN  
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :  
Tespilat :  
Ek :  
www.ihais.gazi.edu.tr  
Şarhname Ekli Dosyada Sunulmaktadır

## Clavulanic Duyarlılık Test Kiti Teknik Şartnamesi

- Her bir kit 3 şişe CLV ( Potassium Clavulanate ) 20 mg/ml + 3 şişe CLV ( Potassium Clavulanate ) 5 mg/ml + 18 şişe Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan , 3 şişe CLV ( Potassium Clavulanate ) 20 mg/ml + 3 şişe CLV ( Potassium Clavulanate ) 5 mg/ml , 1 ml lik ambalajlarda ve liyofilize halde bulunmalıdır.
- Her bir kit 18 adet Diluent içermelidir.
- Her bir diluent şişesi 1,2 ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
- Kitler < 25 C de saklanmalıdır.

Prof.Dr.H.İlbiye ERTOY KARAGÖL  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak.Hast.  
Çocuk Alerji ve İmmünooloji Uzmanı  
Dip.No:T-2002-1807 Dip.Tes.No:119074

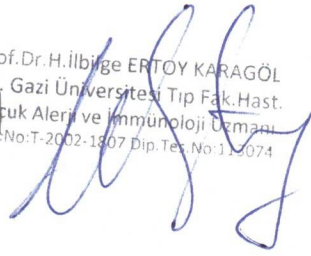


Uzm.Dr. Kerem SETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Alerji ve İmmünooloji Uzmanı  
Çocuk Alerji ve İmmünoolojisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 173187



## APS Bronş Provakasyon Filtresi


- VYAIRE marka APS pro cihazı ile uyumlu olmalıdır .
- APS bronş provakasyon cihazı adaptörüne bağlanmalı ve filtre görevi görmelidir .
- Filtre hiçbir adaptör kullanılmadan direk bağlanmalıdır .
- Hidrofobik polipropilen filtreden yapılmış olmalıdır.

  
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast  
Prof. Dr. Arzu BAKIRTAŞ  
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı  
Dip. No: 93-092-129  
T.C. Tescil No: 66815

  
Prof. Dr. H. İlbelge ERTÖY KARAGÖL  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı  
Dip. No: 93-092-129 Tescil No: 113074

## Amoxicillin Duyarlılık Test Kiti Teknik Şartnamesi

- Her bir kit 3 şişe Sodium Amoxicillin 20 mg + 6 şişe Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan her bir Sodium Amoxicillin 20 mg şişeleri, 1 ml lik ambalajlarda ve liyofilize halde bulunmalıdır.
- Her bir kit 6 adet Diluent içermelidir.
- Her bir diluent şişesi 1,2 ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
- Kitler < 25 C de saklanmalıdır.


  
Prof. Dr. Alibülge ERTAY KARAGÖL  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Alerji ve İmmünooloji Uzmanı  
Din. No: 1 2002-1807 Dip. Tes. No: 113074

  
Uzm. Dr. Kenan ÇETİN  
T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Alerji ve Hastalıkları A.D.  
Çocuk Alerji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 173187


## SMT4101 LANSET, DERİ PRICK

- 1- Deri prik lanset metal malzemeden üretilmiş olmalıdır .
- 2-Prick testlerinin kolay ve emniyetli kullanılmasına uygun olmalıdır.
- 3-Steril , disposable (tek kullanımlık) ve tek tek ambajlarda olmalıdır.
- 4-Kesici ucu 1mm olmalı deri ve deri altına dokusuna zarar vermeden yeterli deri test solüsyonunun deri altına gitmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
- 5-En az 200 lük ambajlarda olmalıdır
- 6- Son kullanma tarihi 1yıldan az olmamalıdır.
- 7-Tek kullanımlık olmalı ve Ürün Avrupa Kalite Belgesine (CE) sahip olmalıdır .

Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast  
Prof. Dr. Arzu BAKIRTAŞ  
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı  
Dip. No: 93-092-129  
Dip. Tesci No: 56815



Prof. Dr. Hilal ERDOĞAN KARAGÖL  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı  
Dip. No: 1-2002-1-07 Dip. Tes. No: 113072

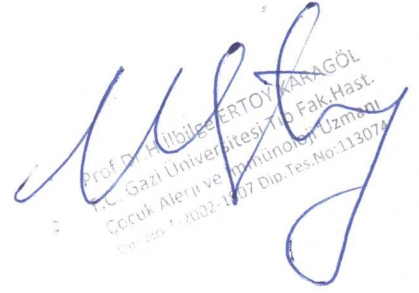



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

Döküm Tarihi : 07/12/2023 13:41:00

İstem No : -1  
İstem Tarihi : 07/12/2023  
Bölüm Adı : Göğüs Hastalıkları Polikliniği Stoğu

Malzeme Kodu : J01-01E772  
Malzeme Adı : OR2740 SOLUNUM FONKSİYON TESTİ İÇİN BAKTERİ FİLTRESİ.

SPIROMETRİ BAKTERİ FİLTRESİ (AĞIZLIKLI)

- 1- Filtre tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- İstenilen filtre ekstra ağızlığa gerek kalmaksızın kendinden ağızlıklı olmalıdır. Ayrıca ağızlık yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına uygun olmalıdır. Bu özellik, ağızlık sarfiyatının önlenmesi ve karton ağızlık kullanımının yarattığı dezavantajların ortadan kaldırılması bakımından gereklidir.
- 3- İstenilen filtrede bakteriyel ve viral filtrasyon birarada olmalıdır. Her iki filtrasyonda da etkinlik %99,99 dan düşük olmamalıdır.
- 4- Teklif edilen ürüne ait filtreleme pedinin, bakteri ve virüs filtrasyon raporları teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 5- Bakteri filtresinin hava akım rezistansı, hem nefes alma hem de nefes verme sırasında %0,70 der fazla olmamalıdır. Ayrıca filtrede ölü boşluk 75 ml den küçük olmalıdır.
- 6- Filtre, laboratuvarımızda bulunan tüm cihazlarla uyumlu olmalıdır. (33/33 mm)
- 7- Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil açılmaz yapıda olmalıdır.
- 8- İstenilen filtrenin ağızlık kısmı ölçüm esnasında hastanın dudaklarının kaymaması için gerekli teknik dizayna sahip olmalıdır.
- 9- İstenilen ürün TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
- 10- Alım sırasında numune gösterilmelidir.
- 11- Malzemenin UBB ve SUT eşleşmesi gerekmektedir.

1  
Uzm. Dr. İbtilaj ERTOY-KARAGÖL  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Allerji ve İmmünoloji Uzmanı  
Dip. No: 2002 1807 Dip. Tes. No: 113074

Uzm. Dr. Kerem ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.  
Çocuk Solunum ve Hastalıkları A. D.  
Çocuk Allerji ve İmmünoloji B. D.  
Dip. Tes. No: 173187

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN