



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No/Alım No : 23832024-12-4122
Konu : Ameliyathane 2 (KVC) Ünitesi için 3 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Ameliyathane Depoları / Ameliyathane 2(Kvc) Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 04/12/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 02/12/2024

TEKLİF İSTEM FORMU

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekseniz FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değeri dikkate alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
****İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatimlma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-014143	OR6050 KLİP (KARTUŞ BAZLI) (SMALL)	360	ADET
2	J01-01F352	KR1061 INTRODUSER SHEATH ANJIOGRAFIK 5 F.	100	ADET
3	J01-011464	KR1061 INTRODUSER SHEATH ANJIOGRAFIK 7 F.	50	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

7f -INTRODUCER SET

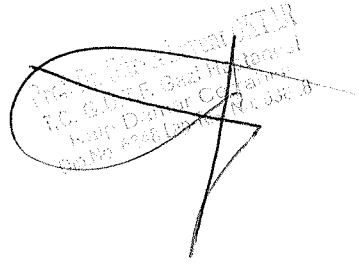
- Introducer Setin damar travmasına yol açmaması açısından sheathden dilatöre düz geçiş olmalıdır.
- Introducer Setler 4F-11F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.
- Vücuda acısız ve kaygan giriş sağlamalıdır.
- Introducer Sheat'in Cross-cut dizaynını bulunduran hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını ve hava aspirasyon riskini de ortadan kaldırmalıdır.
- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
- 5F-11F arası Introducer içinden 0.038inch, 4F Introducer içinden 0,035inch Guide wire geçmelidir.
- Introducer Set içerisindeki Sheat'in uzunluğu 10cm olmalıdır.
- Sheath'e bağlı bir yan uzatma bulunmalıdır.
- Kan kaybını azaltmak için kullanılan STOP-COCK kilitli olmalıdır.
- Sheatler kullanım kolaylığı sağlamak için renk kodlu olmalıdır.
- Introducer Set içerisinde, Sheath, dilatör, spring mini guide wire bulunmalıdır.
- Değişik uygulamalar için geniş bir seleksiyon aralığına sahip olmalıdır.
- Introducer Set'ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.


Prof. Dr. Genel Müdür
T.C. GÜTF. Genel Hastaneleri
Kalp Damar Hastaneleri
Nispetiye Kalp Damar Hastanesi
Nispetiye Kalp Damar Hastanesi

Prof. Dr. Genel Müdür
T.C. GÜTF. Genel Hastaneleri
Kalp Damar Hastaneleri
Nispetiye Kalp Damar Hastanesi
Nispetiye Kalp Damar Hastanesi

5f -INTRODUCER SET

- Introducer Setin damar travmasına yol açmaması açısından sheathten dilatöre düz geçiş olmalıdır.
- Introducer Setler 4F-11F arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.
- Vücuda acısız ve kaygan giriş sağlamalıdır.
- Introducer Sheat'in Cross-cut dizaynını bulunduran hemostaz valfi mükemmel kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısını ve hava aspirasyon riskini de ortadan kaldırmalıdır.
- Sheath içerisindeki dilatörün, dilatör kilidi bulunmalı, kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
- 5F-11F arası Introducer içinden 0.038inch, 4F Introducer içinden 0,035inch Guide wire geçmelidir.
- Introducer Set içerisindeki Sheat'in uzunluğu 10cm olmalıdır.
- Sheath'e bağlı bir yan uzatma bulunmalıdır.
- Kan kaybını azaltmak için kullanılan STOP-COCK kilitli olmalıdır.
- Sheathler kullanım kolaylığı sağlamak için renk kodlu olmalıdır.
- Introducer Set içerisinde, Sheath, dilatör, spring mini guide wire bulunmalıdır.
- Değişik uygulamalar için geniş bir seleksiyon aralığına sahip olmalıdır.
- Introducer Set'ler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.


Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZDEMİR
T.C. Sağlık Bakanlığı
Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi


Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZDEMİR
T.C. Sağlık Bakanlığı
Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TİTANYUM LİGASYON KLİBİ - SMALL BOY (LT200)

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Uygun aplikatörü ile ligasyon işlemi yapılmalıdır.
4. Bir kartuş içerisinde 6 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Kartuş, boyların kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır.
6. Klip iç yüzeyinde, damar üzerinde güvenliği sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
7. Klip dış yüzeyinde, atıcı çenelerindekine uyan ve klabin düşmesini engelleyen, yatay çentikler bulunmalıdır.
8. Klip kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için, uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, dip kısmı sonra kapanmalıdır.
9. Kapalı klip uzunluğu 5mm olmalıdır.
10. Klip ağız açıklığı 3mm olmalıdır.
11. Bir kutu içerisinde 36 adet kartuş olmalıdır.
12. Klip materyeli ferromanyetik olmamalı ve MR ya da CT imajlarını saptırmamalıdır.
13. Klipler kartuş içerisinde, aplikatörden düşmemeleri için, açık şekilde durmalıdır.
14. 72 kartuşa 1 aplikatör verilmelidir
15. Bölüm numune gördükten sonra karar verecektir.

Prof. Dr. Servet GÜNGÖR
T.C. GÜ.L.T.F. Gazi Hastanesi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Diploma No: 5508
Dip. Tescil No: 31063

Prof. Dr. Servet GÜNGÖR
T.C. GÜ.L.T.F. Gazi Hastanesi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Diploma No: 5508
Dip. Tescil No: 31063